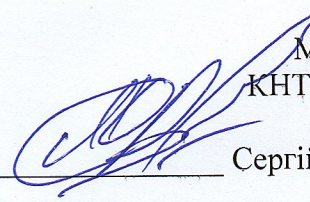


ЗАТВЕРДЖЕНО
Медичний директор
КНТ «ДОКЦДЛ «ДОР»


Сергій МАКСИМЕНКО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів *(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))*

Інформація про замовника торгів: Комунальне некомерційне товариство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради».

Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна.

Інформація про предмет закупівлі:

- Датчики для вимірювання тиску інвазивним методом, одноразового використання (НК 024:2023 35927 Давач для вимірювання артеріального тиску одноразового використання / НК 031:2024 Z12030203 -Медичне обладнання і супутні аксесуари, програмне забезпечення і витратні матеріали інструменти моніторингу артеріального тиску) за кодом ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та виробу медичного призначення різні (код номенклатурної позиції 33195000-3 - Системи моніторингу стану пацієнта).

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозиції ID: UA-2026-05-06-006805-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 420 000 грн. з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі в спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Розмір бюджетного призначення: 420 000 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі розрахунку до кошторису:

Система моніторингу фізіологічних показників пацієнта: Для дорослих пацієнтів, без монітору пацієнта, без Кабель ЕКГ, без електродів, без Датчика SpO2, без Температурного датчика на шкірного, без манжети вимірювання неінвазивного АТ пацієнтам, без АКБ в кількості 600 шт.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Медичний директор
КНТ «ДОКЦДЛ «ДОР»


Сергій МАКСИМЕНКО

ОБГРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Інформація про замовника торгів: Комунальне некомерційне товариство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради».

Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна.

Інформація про предмет закупівлі: Оксигенатор з магістралями для дорослих за кодом ДК 021:2015 33180000-5 Апаратура для підтримання фізіологічних функцій організму.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями ID: UA-2026-05-07-001138-а.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 3 660 000 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі в спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Розмір бюджетного призначення: 3 660 000 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі розрахунку до кошторису: Оксигенатори з магістралями для дорослих: Оксигенатори призначені для використання в екстракорпоральному перфузійному контурі для збору венозної і кардіотомної усмоктуваної крові, її охолодження або нагрівання, оксигенації та видалення з неї вуглекислого газу під час стандартних оперативних втручань з екстракорпоральним кровобігом у дорослих.

- Мембранні оксигенатори повинні постачатися з теплообмінником, комплектом магістралей з артеріальним фільтром, а також мають бути укомплектовані венозно-кардіотомічним резервуаром;
- Покриття має бути фосфорилхолінове;
- Площа поверхні мембрани не більше 1,35 м²;
- Максимальна швидкість потоку крові в межах 7 л/хв;
- Перенос кисню при швидкості потоку крові 7 л/хв не більше 350 с3/хв;
- Перенос вуглекислого газу при швидкості потоку крові 7 л/хв не більше 300 с3/хв;
- Первинний об'єм заповнення оксигенатора не більше 190 мл;
- Мінімальний безпечний рівень крові в венозному кардіотомічному резервуарі не менше 250 мл;
- Ефективність роботи теплообміннику при об'ємній швидкості току крові 4 л/хв в межах від 0,6 до 0,7;
- Площа мембрани теплообмінника не більше 0,08 м²;
- Максимальний об'єм венозно-кардіотомічного резервуару не менше 4 500 мл;
- Розмір пор венозного фільтру не менше 80 мкм;
- Розмір пор артеріального фільтру не менше 40 мкм. в кількості – 120 комплектів.