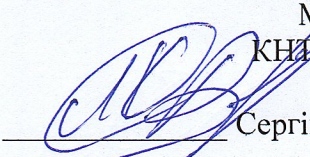


ЗАТВЕРДЖЕНО

Медичний директор

КНІ «ДОКЦДЛ «ДОР»


Сергій МАКСИМЕНКО

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості витратних матеріалів (*оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)*)

Інформація про замовника торгів: Комунальне некомерційне товариство «Дніпропетровський обласний клінічний центр діагностики та лікування» Дніпропетровської обласної ради».

Місцезнаходження: вул. Князя Володимира Великого, буд. 28, м. Дніпро, 49000, Україна.

Інформація про предмет закупівлі: Набір аутотрансфузійний за кодом ДК 021:2015 33140000-3 Медичні матеріали.

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Запит ціни пропозиції ID: UA-2026-06-26-004079-а

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 390 000 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну товару (тобто інформації про ціни, що містяться у відкритому доступі в спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, в електронній системі закупівель «Прозоро», тощо).

Розмір бюджетного призначення: 390 000 грн з ПДВ.

Джерело фінансування – кошти обласного бюджету.

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі зазначена на підставі розрахунку до кошторису:

№ з/п	Найменування предмету закупівлі**	Спеціальні вимоги:	Кількість**
1	Набір для аутогемотрансфузії, для апарату Sorin Xtra Cell Saver 55 ml	1. Наявність резервуару. 2. Наявність мішка для концентрованої еритроцитарної маси. 3. Наявність мішка для відходів. 4. Наявність дзвона стандартного розміру виробника не більше 225 мл. 5. Наявність стерильної головної лінії від резервуару до дзвону.	10 шт
2	Набір аутотрансфузійний для пристрою Sorin Xtra для Cell-Saver TX/175 ml	6. Наявність стерильної лінії для подачі еритроцитів в мішок для концентрованої еритроцитарної маси. 7. Наявність стерильної лінії відмивки від розчину для відмивання до дзвону. 8. Наявність лінії з'єднання резервуару з вакуумним насосом.	10 шт